表 1

政府采购进口产品申请表

申请单位	江汉大学
项目使用单位	江汉大学环境与健

采购项目所属项目名称 “创新”建设实验教

教师的科研需求，目前我院有一台热重分析仪，为 2015

3、联用接口部分：具有同步触发器，包括 TGA 和 FTIR 可实现软件和硬件双控同步触发功

气体池和管线单独控温模块，可加热温度≥200℃，具备载气流量显示和

分辨率≤0.8cm，实

仅能达到 40000:1，影响低浓度物的检测能力；2.国

产热重分析仪升温速率最大仅 100℃/min，存在加热不均匀、温度无法

约的基线噪音大，漂移严重，导致测量数据不稳定，无法满足精确分析需要，因此申请采购进口热


重红外联用仪

说明：1.对于政府采购范围的进口产品，需在采购前填报此表。

2.此表内容须用计算机录入，A4 纸打印，一式 3 份。

表 1

政府采购进口产品申请表

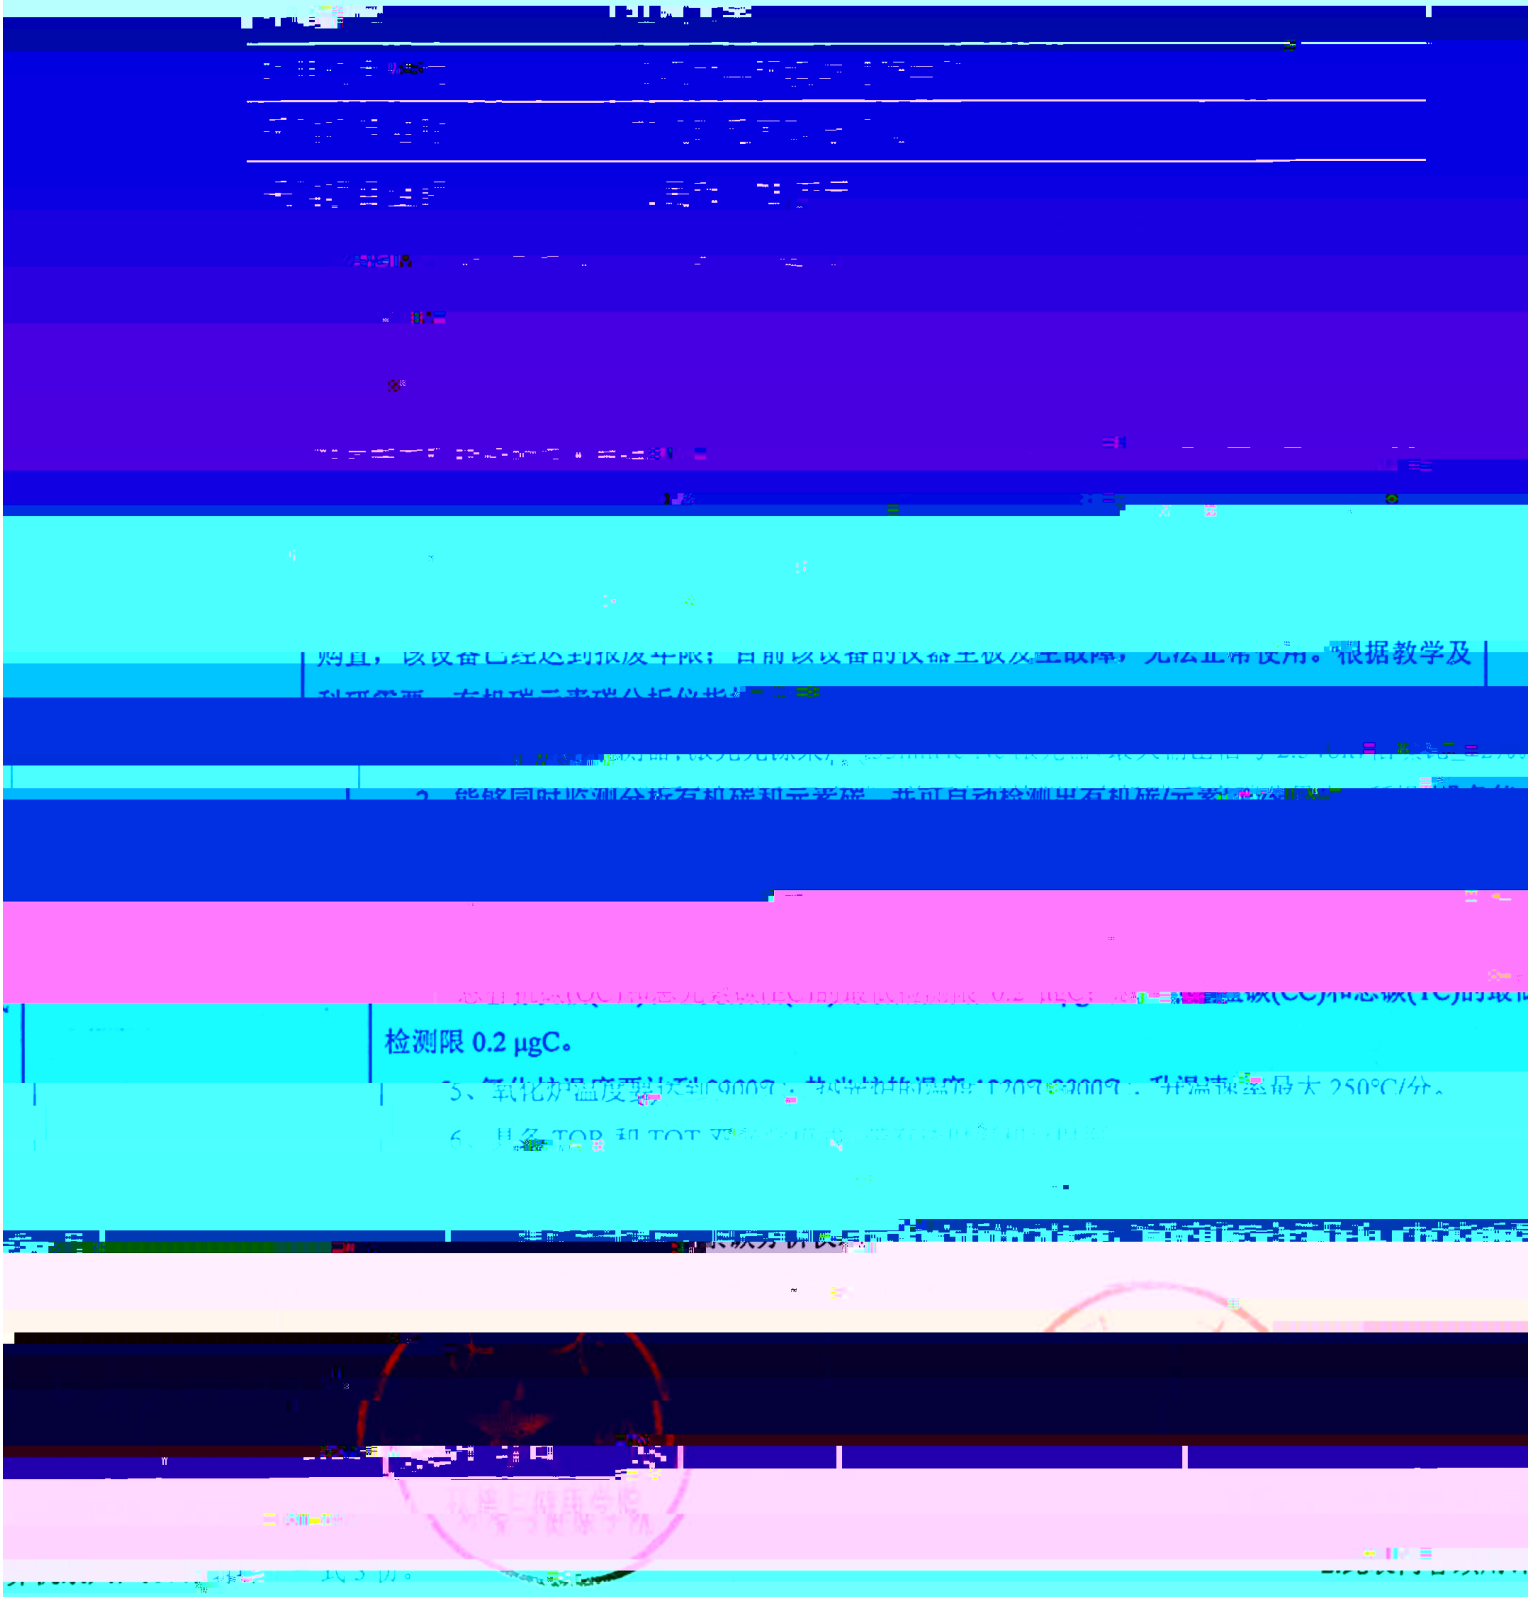


检测限 0.2 μgC。

5、氧化炉温度要达到900℃，热解炉的温度在120℃-900℃，升温速率最大 250℃/分。

6、具备 TOR 和 TOT 双

表 2

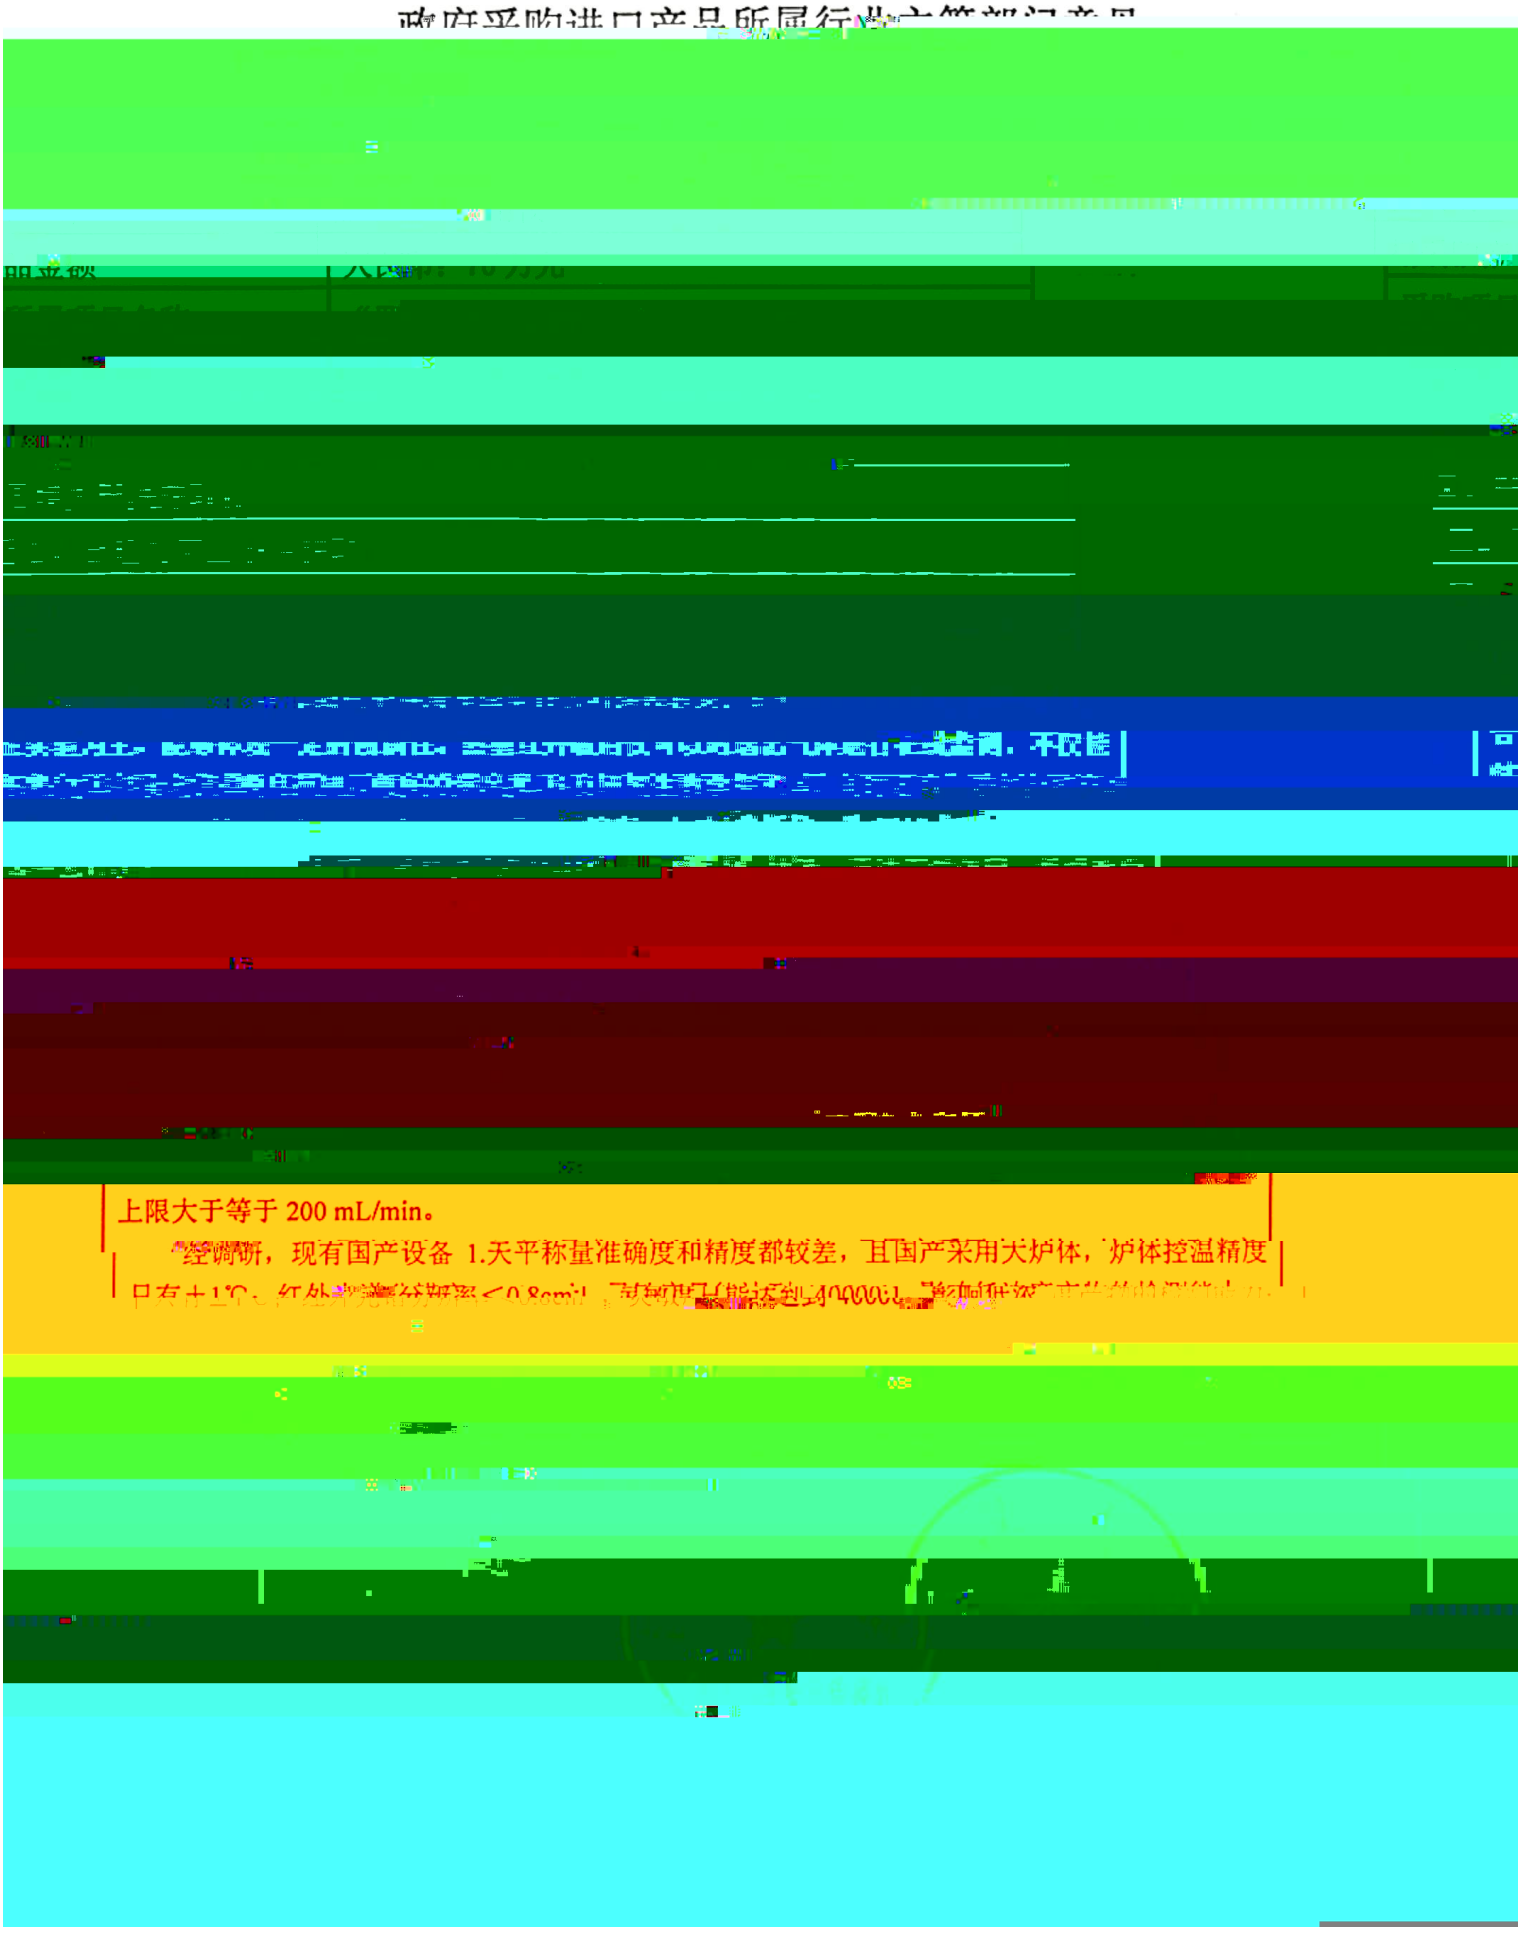

上限大于等于 200 mL/min。

经调研，现有国产设备 1.天平称量准确度和精度都较差，且国产采用大炉体，炉体控温精度

表 2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

采购项目名称	有机[illegible]分析仪
采购项目金额	人民币：75 万元
采购项目所属项目名称	“四新”建设实验教学设备更新项目（[illegible]）
[illegible]	人民币：197 万元

[illegible]光炉的温度 120℃-900℃，升温速率最大 250℃/分。

[illegible]式--带有透射率和反射率。

[illegible]进行连接，拓展仪器的应用。

[illegible]及主要教学科研的需求，采用国产品采购进口仪器。

[illegible]部门意见

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	武汉大学
拟采购产品名称	[redacted]
拟采购产品名称	[redacted]
采购项目所属项目名称	[redacted]
采购项目所属项目金额	人民币：197 万元

二、申请理由

☑1. 中国境内无法获取；


[redacted]

[redacted]

[redacted]

表3

政府采购进口产品专家论证意见

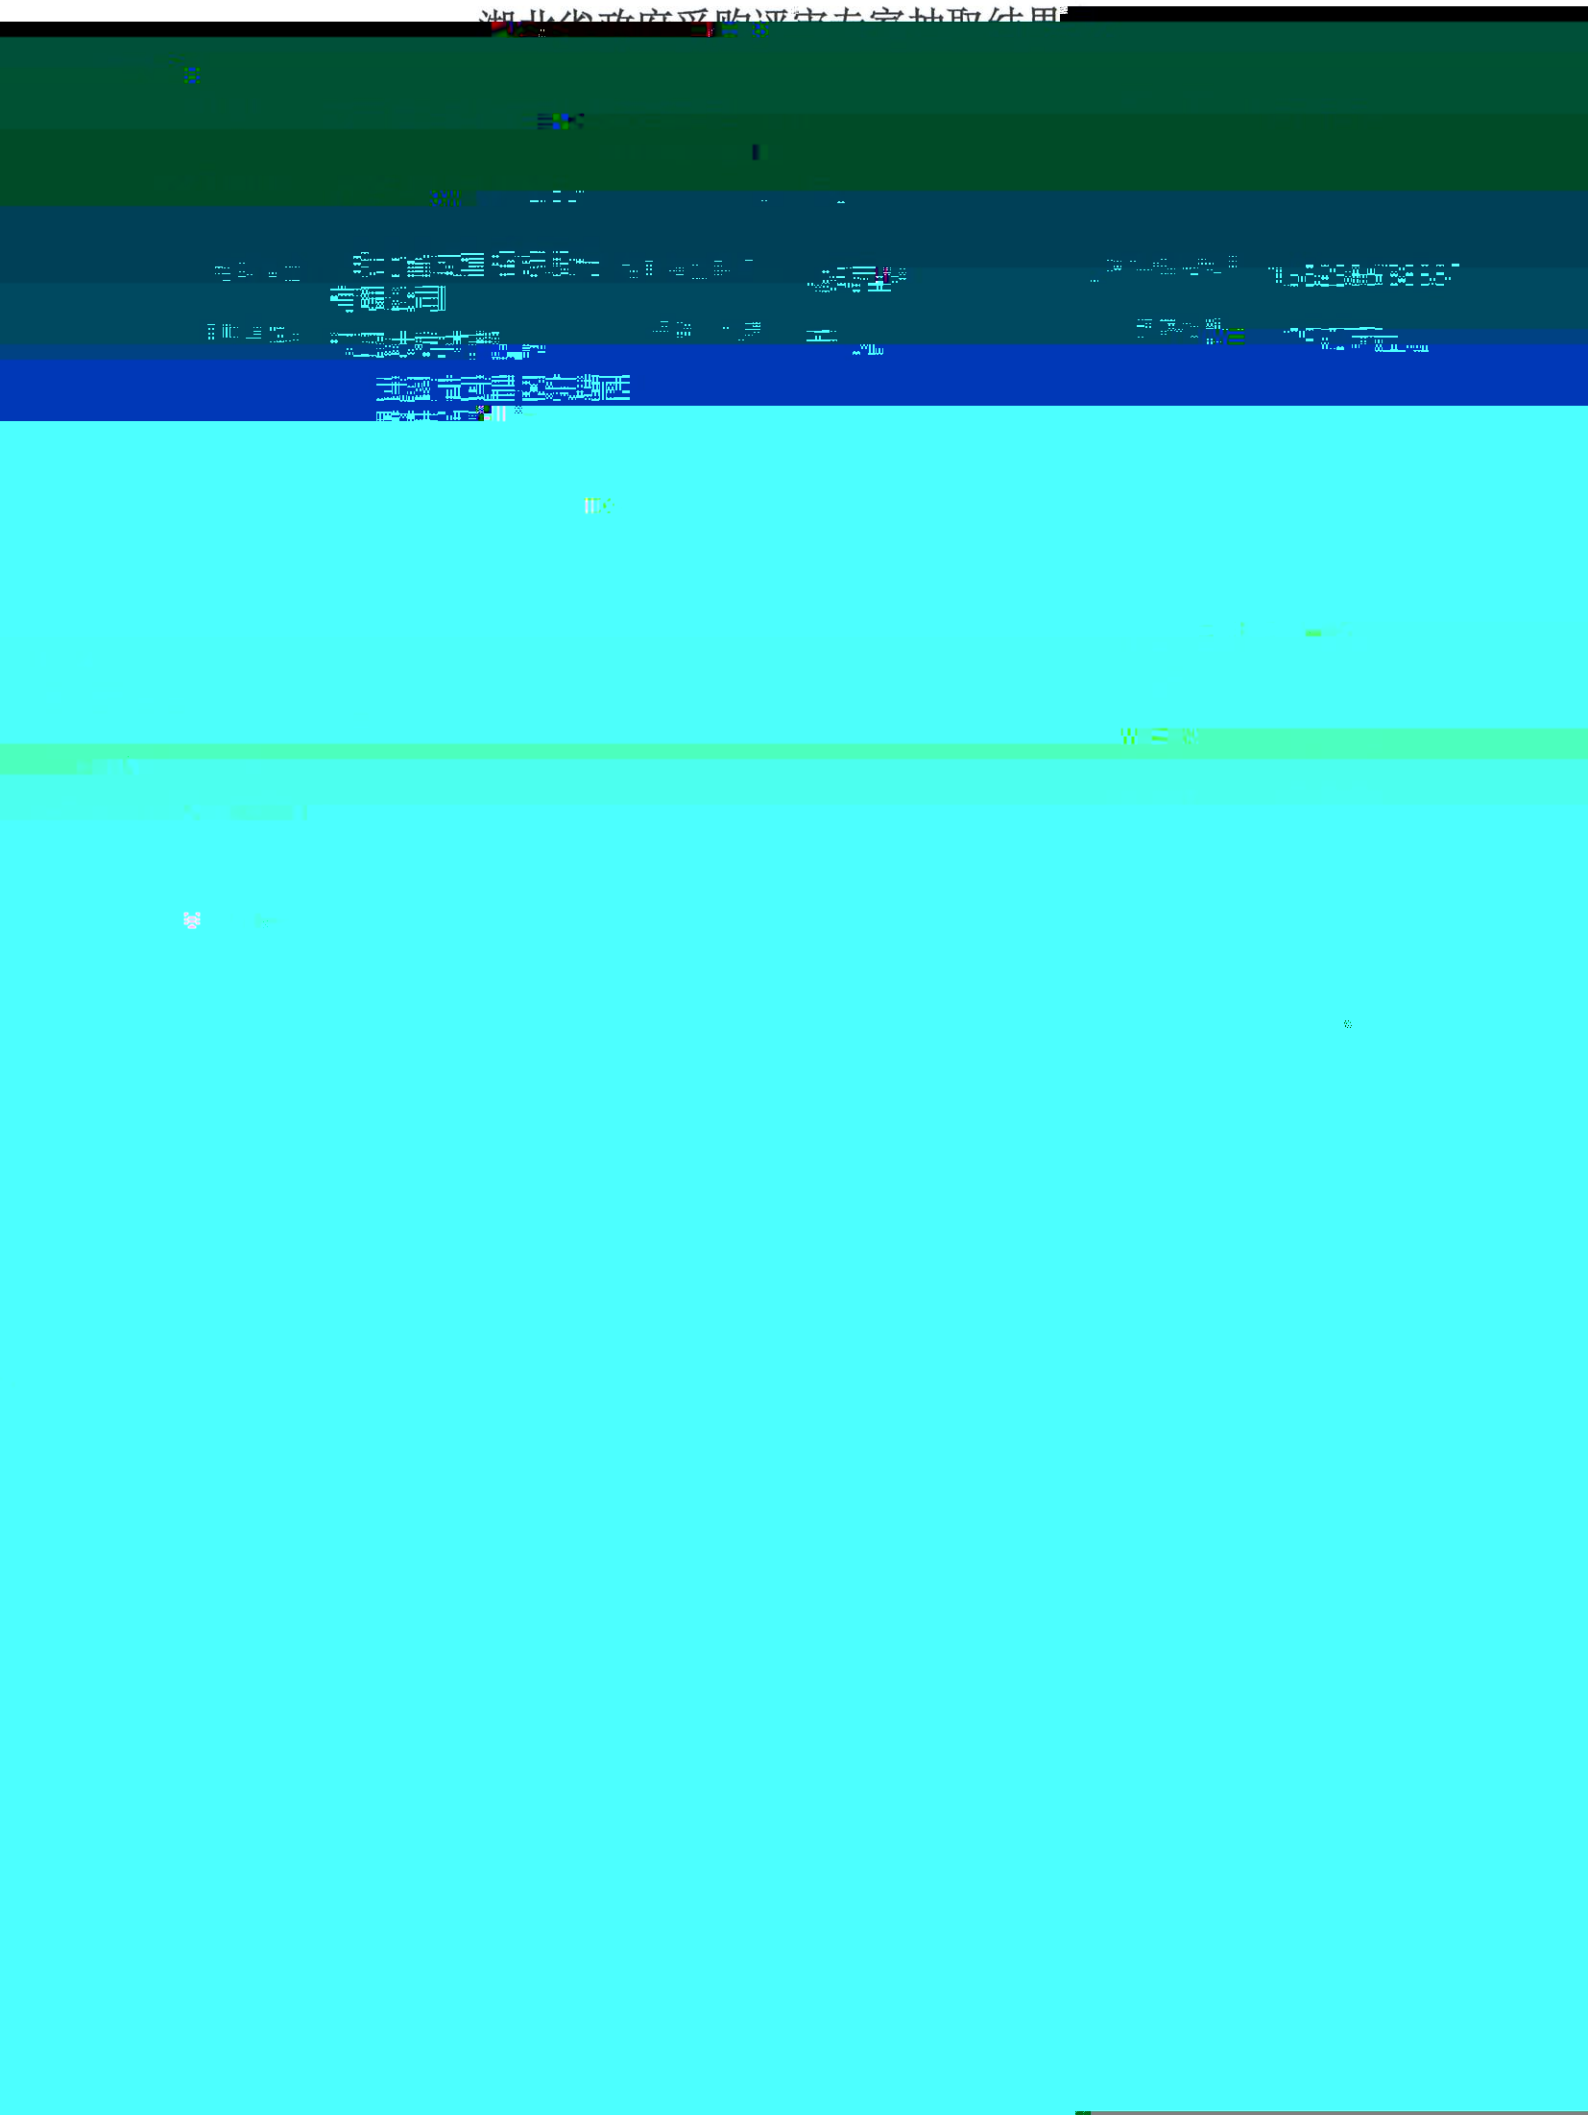



签到表

移动电话
38712 9116
89710 8987
59027 6072
36386 8256
57165 5628

期：2026 年 05 月 09 日